



A DIRECT HEALTHCARE GROUP COMPANY

# Mover Plus

Bruksanvisning/Service manual



MOVER

# Mover Plus

Mover Plus är en överflyttningsplattform som är utvecklad för bekväm och smidig överflyttning. Den är enkel att använda och underlättar för brukare att förflyttas på ett säkert och bekvämt sätt. Mover Plus är utrustad med en smal bottenram och dubbelhjul för enkel manövrering även på små utrymmen. Med en stabil ståplatta, bekväma sittdynor och ständig ögonkontakt med vårdgivaren kan brukaren alltid känna sig bekväm och trygg med Mover Plus.

## Innehåll

1. Allmän information	04
2. Förord	04
3. Service och support	04
4. Tillverkare	04
5. Avsedd användning	04
6. Förväntad livslängd	05
7. Identifiering av produkten	05
8. ID-märkning	05
9. Policy om antal personer för att förflytta en vårdtagare	05
10. Säkerhetsanvisningar	05
11. Produktbeskrivning	06
12. Så här använder du Mover Plus	07
13. Skötsel och underhåll	08
14. Rengöring	08
15. Återvinning	09
16. Tekniska specifikationer	09
17. Dimensioner	11

## 1. Allmän information

Tack för att du köpt denna överflyttningsplattform från GATE. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant och kontakta oss om du har några frågor om användningen eller underhållet av "Mover Plus – Överflyttningsplattform".

## 2. Förord

Läs hela bruksanvisningen innan du använder produkten. Informationen i bruksanvisningen är viktig att förstå för att produkten ska kunna användas och underhållas på rätt sätt.

Förvara bruksanvisningen tillsammans med produkten så att den kan användas som referens vid behov. Se till att alla som ska använda produkten får en regelbunden utbildning i hur produkten ska användas.

Produkten får ej modifieras utan tillåtelse från producenten.

Produkten är CE-märkt enligt MDD 93/42/EEG.

## 3. Service och support

Produkten ska alltid kontrolleras innan användning. Dessutom rekommenderar vi en allmän översyn 1 gång per år.

Se vidare under avsnittet "Skötsel och underhåll".

## 4. Tillverkare

GATE Rehab Development AB  
Box 2  
S-333 03 Reftele  
tel 0371-318 00  
info@gaterd.se

## 5. Avsedd användning

Mover Plus – Överflyttningsplattform är en mobil överflyttningsplattform med en säker arbetslast på 150 kg. Produkten är avsedd att användas på plana ytor i syfte att förflytta vårdtagare och boende på sjukhus, sjukhem eller inom hemsjukvården.

Produkten är enbart avsedd att användas för vårdtagare som klarar att stå upp utan hjälp, eller som kan stå med minimal hjälp.

Produkten är ej avsedd för långa perioder av sittande eller förflyttning.

Produkten är avsedd att förflytta en vårdtagare till/från stol, säng, rullstol eller toalett. Med vårdtagare avses här den personen som förflyttas.

Riktningshänvisningar i detta dokument (vänster/höger, framåt/bakåt) görs alltid utifrån vårdpersonalens skjutande position/vänd mot vårdtagare.

Mover Plus är ej konstruerad för att användas i dusch.

## 6. Förväntad livslängd

Den förväntade livslängden på produkten är minst 10 år givet att regelbundet underhåll utförs och att trasiga detaljer byts vid behov. Kontakta Distributören om någon del behöver bytas.

## 7. Identifiering av produkten

Det unika serienumret visas på en dekal som är placerad under ståplattan.

## 8. ID-märkning

1	53-302	5
2	Mover Plus	
3	2011-04-20	SN 2468
4	Max 150 Kg	CE
	Bredd/Width/Breite (cm): 78 -- 81	GATE Gate Rehab Dev. AB Tel. +46 371 31800 www.gaterd.se
6	Endast för bruk INOMHUS Only for INDOOR useage Nur für im HAUSE Benutzen.  (01)07350013563126(21)2468	

1. Artikelnummer  
2. Produktnamn  
3. Tillverkningsdatum  
4. Max brukarvikt  
5. Serienummer  
6. EAN kod

## 9. Policy om antal personer för att förflytta en vårdtagare


Denna produkt är designad för att kunna användas på ett säkert sätt av en vårdare. Det kan finnas omständigheter hos vårdtagaren som ska förflyttas som gör det nödvändigt att två vårdare genomför förflyttningen.

Varje professionell vårdgivare har själv alltid ansvar för att bedöma om produkten är lämplig att användas samt om en förflyttning/överflyttning behöver göras av en eller två vårdare.

## 10. Säkerhetsanvisningar

- Denna produkt är enbart avsedd för förflyttning av vårdtagare. All annan användning är ej tillåten.
- Denna produkt är konstruerad och testad för att säkert klara förflyttning/överflyttning av vårdtagare med en kroppsvikt av max 150 kg.
- Utför alltid rekommenderat dagligt underhåll innan produkten används.
- Förflytta alltid produkten genom att använda körhandtagen.
- Innan produkten ska användas så ska en klinisk bedömning göras huruvida vårdtagaren kan flyttas med denna produkt och isåfall om förflyttning/överflyttning ska göras av en eller två vårdare.
- Flytta ej en belastad produkt över hinder som hjulen ej lätt kan ta sig över (höga mattkanter, trösklar mm).
- Åtgärda ev. lacksskador snarast för att undvika kortare livslängd pga korrosion.
- Låt ej Mover Plus stå i direkt solljus då mörka ytor kan bli mycket varma.

## 11. Produktbeskrivning

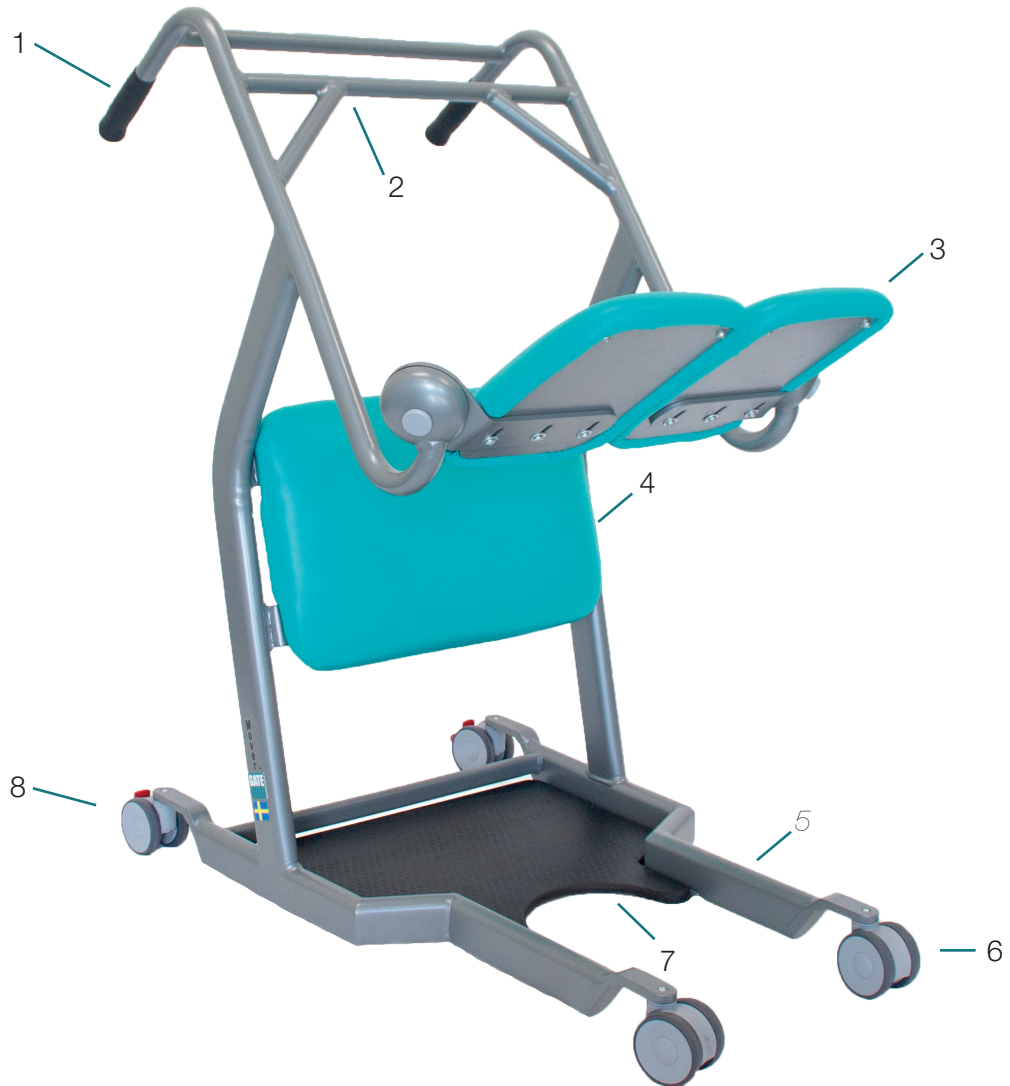

1. Manöverhandtag
2. Tvärstag/handtag
3. Justerbara säteshalvor/sätessdynor
4. Justerbart knäskydd
5. Ben
6. Främre styrhjul utan broms
7. Ståplatta
8. Bakre styrhjul med broms

## 12. Så här använder du Mover Plus

### Vrida kuddarna

1. Håll säteshalvan i handtaget i övre hörn.
2. Vrid säteshalvan antingen bort från förflyttningsområdet eller i läge under vårdtagaren.



### Dra åt och lossa bromsarna på de bakre styrhjulen



Lås bromsen



Lossa bromsen

### Så här genomför du en förflyttning/överflyttning

1. Momenten nedan visas för en överflyttning från en stol/rullstol/säng/toalett till en annan men görs på samma sätt oavsett om förflyttningen/överflyttningen görs från en stol, säng, rullstol eller toalett.



1. Fäll upp de två säteshalvorna.



2. Kör intill vårdtagaren.



3. Lås bromsen



4. Placera Mover Plus så att vårdtagaren enkelt kan placera sina fötter på fotplattan och knä/underben mot knäskyddet. Låt vårdtagaren greppa i den tvärgående stängeln eller handtagen och sedan resa sig upp.

## Så här genomför du en förflyttning/överflyttning fortsättning



5. Fäll ner de två säteshalvorna.



6. Be vårdtagaren att sitta ned. Lossa sedan bromsen och förflytta vårdtagaren.

2. För att göra en överflyttning till en stol/rullstol/säng/toalett gör du ovanstående moment i omvänd ordning.

3. Vid förflyttning till Toalett:

- När vårdtagaren är på plats så aktiveras bakre hjuls bromsar och vårdtagaren står upp.
- Ta av vårdtagarens kläder vid behov och fäll sedan upp sätets halvorna så att vårdtagaren kan sätta sig själv på toaletten. Produkten kan nu fungera som en stödramp vilket underlättar för vårdtagaren under toalettbesöket.

## Individuella inställningar



För extra individuell anpassning kan både knäskyddet och sätesdynorna justeras (justeringsmån 25 mm).

1. Lossa på alla skruvarna och justera knäskyddet/sättesdynorna till den önskade höjden.
2. Skruva åt och använd Mover Plus enligt "12. Så använder du Mover Plus".

Som tillbehör finns även 53-329 Extender, som justerar knästödet på djupet mot brukaren med 30 mm.

## 13. Skötsel och underhåll

### Schema för förebyggande underhåll

Om produkten vid kontroll har felaktiga/trasiga delar så ska den ej användas innan felaktiga detaljer bytts ut.

Åtgärd/Kontroll	Före varje användning	Årlig översyn
Gör en översiktlig kontroll-testa produktens funktioner. Kontrollera att inga detaljer är trasiga eller spruckna. Kontrollera att produkten känns stabil.	x	x
Kontrollera att sitshalvor kan fällas upp/ned.	x	
Kontrollera att de bakre hjulen kan roteras och bromsas.	x	
Kontrollera att ståplattan sitter fast.	x	x
Kontrollera att hjulen sitter fast ordentligt i chassit.		x
Undersök utsatta delar med avseende på sprickor eller vassa kanter (dessa kan bli ohygieniska eller skada vårdtagaren)		x
Kontrollera att inga lösa skruvförband finns.		x



## 14. Rengöring

Produkten ska rengöras/desinficeras regelbundet – mellan varje användning vid behov eller minst en gång per dag. Rengör produkten genom att torka med en fuktig trasa fuktad med varmt vatten och desinficerande rengöringsmedel. Torka ordentligt för att effektivt desinficera alla ytor. Använd inte klorin, fenoler, pentanoler eller andra starka rengöringsmedel som kan skada ytan/torka ur kuddar och ge sprickor i förtid.

## 15. Återvinning/kassering

När produkten inte längre kan användas bör den återvinnas i enlighet med lagar/föreskrifter för avfallshantering i respektive land. Alla elektriska delar inkl. batterier måste tas bort och återvinnas som elektriska komponenter. (Rådgör med er lokala återvinningsanläggning för mer information om hur de olika materialen i produkten (metall, plast, elektronik) ska återvinnas).

## 16. Tekniska specifikationer

Se skiss på s. 10

Pos. No.	Art.nr	Benämning
1	53-341	Ändskruv M10, Ø30 mm
2	53-342	Skruv, Knästödsplatta (x4)
3	53-344	Gummihandtag, L=92 mm (x2)
4	53-350	Ståplatta Plus
5	53-336	Skruv, Sittplatta (x3)
6	53-337	Skruv, ståplatta (x4)
7	53-338	Bricka, sittplatta (x3)
8	53-339	Låsmutter M10
9	53-340	Bricka M10
10	53-312	Dubbelhjul utan broms Ø75 mm
11	53-351	Dubbelhjul med totalbroms "diameter" 75mm
12	53-352-L	Stödjärn, sittplatta vänster
13	53-352-R	Stödjärn, sittplatta höger
14	53-353-L/R	Sits, Plus
15	53-354	Knästöd, Plus
16	53-334	Bricka/Knästödsplatta (x4)

MOVER



## 17. Dimensioner



Produktens vikt: 29,5 kg



A DIRECT HEALTHCARE GROUP COMPANY

Gate Rehab Development AB  
Box 2  
S-333 03 Reftele

T: 0371-318 00  
F: 0371-318 01  
E: [info@gaterd.se](mailto:info@gaterd.se)

Datum: 2020-08-27

GATERD.SE